

アデノウイルスキット
「**イムノエースアデノ**」製品改良及び仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。
さて、この度「**イムノエースアデノ**」の最終判定時間を8分から**5分**へ製品改良しましたのでお知らせ致します。

また、10テスト包装、30テスト包装、30テスト(輸送用スワブ付)包装、テストプレート10テスト包装の4製品は裏面の通り仕様変更しております。

今回の改良によるカタログ番号・JANコード・価格・有効期間の変更はございません。

今後とも、お客様のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


謹白

記

下記のLot番号より変更致します。


製品コード・製品名	Lot番号	出荷予定時期
IAAD0350 イムノエースアデノ 10テスト	IA108DT2008	2018年6月中旬
IAAD0340 イムノエースアデノ 30テスト	IA308DT2005	2018年6月中旬
IAAD0360 イムノエースアデノ 30テスト(輸送用スワブ付)	TA308DT2004	2018年7月上旬
IAAD0325 イムノエースアデノ テストプレート 10テスト	IAPA8DT2005	2018年8月上旬

※流通事情により若干の差異が生じる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。
製品には、以下の「お知らせ」用紙を同梱しております。

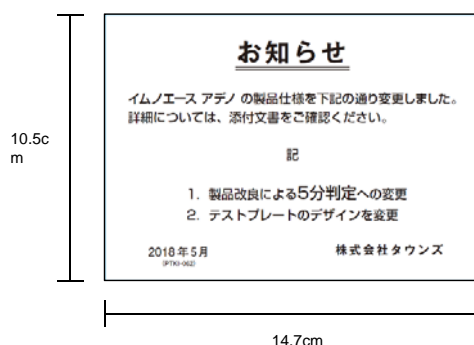

以上

アデノウイルスキット
「**イムノエースアデノ**」仕様変更一覧

旧タイプ	仕様	新タイプ
 <p>判定時間8分 (8min.)</p>	【テストプレート】	 <p>判定時間5分 (5min.)</p>
 <p>専用紙</p>	【操作ガイド】	 <p>30テスト包装 及び 30テスト(輸送用スワブ付)包装 → ← 10テスト包装 化粧箱のフタ(内側)の部分への印刷</p>
 <p>W242mm X D88mm X H69mm</p>	【化粧箱】 ※ 10テスト包装	 <p>サイズ変更なし</p>
 <p>W223mm X D187mm X H93mm</p>	30テスト包装	 <p>サイズ変更なし</p>
 <p>W223mm X D187mm X H93mm</p>	30テスト (輸送用スワブ付) 包装	 <p>サイズ変更なし</p>
 <p>W125mm X D70mm X H45mm</p>	テストプレート 10テスト包装	 <p>サイズ変更なし</p>

※ 化粧箱のサイズ変更・C/S(元箱)入り数の変更はありません。

10テスト包装：30箱、30テスト包装・30テスト(輸送用スワブ付)包装：12箱、テストプレート包装：設定なし